

TESTNA TRAKA ZA KONTROLU RAZINE PEROCTENE KISELINE

Za aktiviranu otopinu ANIOXYDE 1000

INDIKACIJE

Kontrola razine perocetene kiseline u otopini za hladnu sterilizaciju ANIOXYDE 1000.

UPUTE ZA UPORABU

- Svakodnevno se koristite trakom za ispitivanje kako biste provjerili aktivnost radne otopine:
Na početku dezinfekcije ili prilikom ponovnog počinjanja nakon prekida.
Svaka 4 sata uzastopne aktivnosti (više od 10 endoskopa dnevno).
- Tijekom razdoblja učestale aktivnosti ili u posebnim uvjetima (porasti temperature, itd.) možda će biti potrebno povećati učestalost uporabe traka.
- Cijeli reaktivni dio testne trake natapajte 1 sekundu u otopini koja se ispituje.
- Višak otopine uklonite blagim protresanjem testne trake.
- Rezultat očitajte 10 sekundi nakon natapanja. Rezultat nikada ne očitavajte nakon 15 sekundi.

UVJETI ČUVANJA

Rok trajanja testnih traka ovisi o danu kada su spremljene:

- 30 mjeseca od dana spremanja na temperaturi između +4°C i +30°C.
- 90 dana nakon otvaranja.

Čuvanjem zatvorenog pakiranja osigurava se trajnost testnih traka.

Datum otvaranja :

INFORMACIJE



Žuta boja otopine Anioxyde 1000 pokazuje da je smjesa aktivatora i generatora upravo napravljena, ali NE pokazuje je li perocetena kiselina prisutna u otopini ili nije.

U obzir treba uzeti isključivo boju testne trake.

Obojena otopina (žuta) ili ne + boja testne trake (crna).

Tamno plava do crna boja,

- Bezbojna,
- Brzo nestajanje boje,
- Sitne točkice,
- Obojeni rub

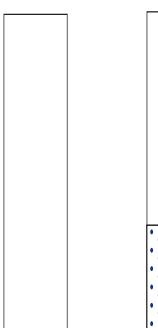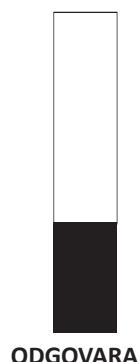

NE ODGOVARA



PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Zastupnik i distributer za Republiku Hrvatsku,
Prilaz baruna Filipovica 25,
10000 Zagreb, Hrvatska.
Tel.: + 385 1 37 20 000,
Faks: + 385 1 37 20 111;
www.pliva.hr, www.plivamed.net

**Laboratoires
ANIOS**
Le professionnel de la désinfection
www.anios.com

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tel. +33 3 20 67 67 67 - Fax: +33 3 20 67 67 68

HR/ANIO/17/0019 - datum sastavljanja: 03/2017
SAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE